

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade: PD-152 – cod. 35 25 150 152 – 0-150 mm – 0-6”

PD-202 – cod. 35 25 200 202 – 0-200 mm – 0-8”

Resolução: 0,01 mm – 0,0005”

Exatidão: ± 0,03 mm

Medições: Externa(8), Interna(2), Profundidade(6) e Ressalto(10).

Funções: Liga (7) **0/ON**

Zeragem em qualquer posição (7)


Conversão de unidade de medida mm/polegada (7)

Desligamento automático

Grau de Proteção: IP-67

Alimentação: Bateria CR-2032

Temperatura de trabalho: 0 ~ +40 °C

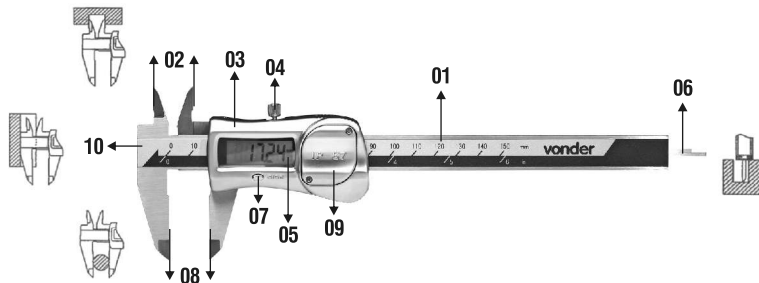

01. Escala principal graduada

02. Faces para medição interna – “orelhas”

03. Cursor

04. Parafuso de fixação do cursor

05. Mostrador/visor de cristal líquido

06. Haste para medição de profundidade

07. Botão liga/desliga (a), “Zero” (b) e conversão mm/polegada (c)

08. Faces para medição externa – “bicos”

09. Tampa do compartimento da bateria

10. Face para traçagem ou medição de ressalto

INSTRUÇÕES DE USO:

- Para o paquímetro pressione o botão (7) **0/ON**, o desligamento é automático após 5 minutos sem uso.
- Para zeragem do mostrador/visor em qualquer posição pressione o botão (7) **0/ON**.
- Para converter a unidade de medida mm/polegada, mantenha pressionado por aproximadamente 5 segundos o botão (7) **0/ON**.
- Para reposição da bateria, utilize uma chave de fenda cruzada/Phillips para soltar os 2 parafusos e abra a tampa (9), remova a bateria usada e coloque uma bateria nova CR-2032 mantendo o pólo + voltado para cima, recoloque a tampa (9) e fixe os 2 parafusos. A troca da bateria é recomendada quando o paquímetro não liga pressionando-se o botão (7) **0/ON** ou quando os dígitos aparecem piscando intermitentemente no visor.
- Caso o paquímetro deixe de ser utilizado por mais de 5 minutos o visor desliga automaticamente para economia de energia, para religar basta pressionar o botão (7) **0/ON**.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS:

- Quedas, impactos fortes, movimento brusco do cursor, manutenção indevida, exposição à luz solar ou grandes variações de temperatura podem causar danos irreversíveis ao paquímetro e perda do direito de garantia.
- Nunca utilizar o paquímetro para fazer medições com a peça em movimento ou deslizar as faces de medição sobre a peça, este procedimento provoca o desgaste prematuro das faces de medição, alterando a precisão e até mesmo inutilizando o instrumento.
- Mantenha o paquímetro sempre limpo e seco-(nunca lavar ou mergulhar em líquidos e para limpeza utilizar tecido macio ou camurça) e guarde-o em local apropriado e protegido, longe de fontes de calor e umidade.
- Remova a bateria caso o paquímetro não seja utilizado por longo período.
- O contato do paquímetro com fontes de eletricidade ou superfícies magnéticas pode causar danos irreversíveis ao sistema eletrônico.